PASO 1: Elija el lugar.
PASO 2: Limpie el lugar con una toallita humedecida con alcohol y déjelo secar.
PASO 3: Quite la tapa por completo del envase del sensor. Desenrosque el tapón del aplicador del sensor.

> **PRECAUCIÓN: El código del sensor debe ser el mismo en el envase y en el aplicador del sensor.** NO use si algún elemento está dañado o ya está abierto.

PASO 4: Alinee las marcas oscuras del aplicador del sensor y del envase del sensor. Sobre una superficie dura, presione firmemente hacia abajo en el aplicador del sensor hasta que se detenga.
PASO 5: Levante el aplicador del sensor para retirarlo del envase del sensor.
PASO 6: El aplicador del sensor está listo para aplicar el sensor.

> **PRECAUCIÓN:** El aplicador del sensor ahora contiene una aguja. NO toque el interior del aplicador del sensor ni vuelva a colocarlo en el envase del sensor.

PASO 7: Coloque el aplicador del sensor sobre el lugar elegido. Presione hacia abajo con firmeza para aplicar el sensor.

> **PRECAUCIÓN:** NO presione el aplicador del sensor hasta que esté colocado sobre el lugar preparado, a fin de evitar lesiones o resultados no deseados.

PASO 8: Con suavidad, tire del aplicador del sensor para quitarlo.
PASO 9: Compruebe que el sensor esté bien sujeto. Deseche el aplicador del sensor y el envase del sensor usados de conformidad con la reglamentación local.

Para usar el sistema, consulte el manual del usuario que se incluye en el kit del lector.

1a ETAPA: Selecione o local.
2a ETAPA: Limpe o local com um lenço umedecido com álcool e deixe o local secar.
3a ETAPA: Retire completamente o lacre do recipiente do sensor. Desrosqueie a tampa do aplicador do sensor.

> **ATENÇÃO: Os códigos do recipiente do sensor e do aplicador do sensor devem ser iguais.** NÃO utilize se já estiver aberto ou danificado.

4a ETAPA: Alinhe as marcas escuras do aplicador do sensor e do recipiente do sensor. Em uma superfície dura, pressione para baixo com firmeza o aplicador do sensor até que ele pare.
5a ETAPA: Levante o aplicador do sensor para fora do recipiente do sensor.
6a ETAPA: O aplicador do sensor está pronto para aplicar o sensor.

> **ATENÇÃO:** Agora o aplicador do sensor contém uma agulha. NÃO toque na parte interna do aplicador do sensor nem o devolva ao recipiente do sensor.

7a ETAPA: Posicione o aplicador do sensor sobre o local de aplicação. Empurre firmemente para baixo para aplicar o sensor.

> **ATENÇÃO:** NÃO empurre o aplicador do sensor para baixo antes de posicioná-lo sobre o local preparado, para evitar resultados involuntários ou ferimentos.

8a ETAPA: Retire com cuidado o aplicador do sensor.
9a ETAPA: Certifique-se de que o sensor esteja firme. Descarte o aplicador do sensor e o recipiente do sensor usados de acordo com as regulamentações locais.

Para utilizar seu sistema, consulte o Manual do Usuário incluso no Kit do leitor.

29597-105B

STEP 1: Select site.
STEP 2: Clean site with alcohol wipe and allow site to dry.
STEP 3: Peel lid completely off Sensor Pack. Unscrew cap from Sensor Applicator.

> **CAUTION: Sensor codes must match on Sensor Pack and Sensor Applicator.** Do NOT use if damaged or already opened.

STEP 4: Line up dark marks on Sensor Applicator and Sensor Pack. On a hard surface, press down firmly on Sensor Applicator until it comes to a stop.
STEP 5: Lift Sensor Applicator out of Sensor Pack.
STEP 6: Sensor Applicator is ready to apply Sensor.

> **CAUTION:** Sensor Applicator now contains a needle. Do not touch inside Sensor Applicator or put it back into Sensor Pack.

STEP 7: Place Sensor Applicator over site. Push down firmly to apply Sensor.

> **CAUTION:** Do NOT push down on Sensor Applicator until placed over prepared site to prevent unintended results or injury.

STEP 8: Gently pull Sensor Applicator away.
STEP 9: Make sure Sensor is secure. Discard used Sensor Applicator and Sensor Pack according to local regulations.

To use your system, refer to the User's Manual included in the Reader Kit.

1



2

3

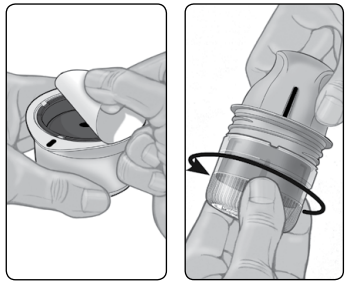

4



5



6



7



8



9

Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre

LEA ESTE PROSPECTO Y EL MANUAL DEL USUARIO QUE ACOMPAÑA EL KIT DEL LECTOR ANTES DE MANIPULAR LAS PIEZAS DEL KIT DEL SENSOR.

Indicaciones de uso

El Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre está indicado para medir el nivel de glucosa en el líquido intersticial de personas (a partir de los 4 años de edad) con diabetes mellitus. La indicación para menores de edad (entre 4 y 17 años) se restringe a aquellas personas supervisadas por una persona que los cuide que tenga al menos 18 años de edad. La persona a cargo del cuidado es responsable de manejar o ayudar al menor de edad a manejar el Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre y también de interpretar o ayudar al menor de edad a interpretar las lecturas de FreeStyle Libre. Está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre en el autocontrol de la diabetes, salvo en las circunstancias que se enumeran a continuación. **En las siguientes circunstancias, utilice un medidor de glucosa en sangre para verificar las lecturas actuales de glucosa obtenidas con el sensor del Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre:**

- **Cuando los niveles de glucosa cambian rápidamente, los niveles de glucosa intersticial medidos por el sensor e informados como actuales pueden no reflejar los niveles de glucosa en sangre de manera exacta.** Cuando los niveles de glucosa bajan rápidamente, las lecturas de glucosa del sensor pueden ser más altas que los niveles de glucosa en sangre. Por el contrario, cuando los niveles de glucosa suben rápidamente, las lecturas de glucosa del sensor pueden ser más bajas que los niveles de glucosa en sangre.
- **Para confirmar hipoglucemia o hipoglucemia inminente informada por el sensor.**
- **Si los síntomas no concuerdan con la lectura del Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre. Los síntomas que puedan ser consecuencia de hipoglucemia o hiperglucemia no se deben pasar por alto.**

CONTRAINDICACIÓN:

El Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre debe quitarse antes de someterse a un estudio de imágenes por resonancia magnética (RM).

ADVERTENCIA:

- El Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si se ingieren.
- **Cuando los niveles de glucosa cambian rápidamente (más de 2 mg/dL [0,1 mmol/L] por minuto), los niveles de glucosa en el líquido intersticial medidos por el sensor del Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre pueden no reflejar los niveles de glucosa en sangre de manera exacta. En estas circunstancias, verifique las lecturas de glucosa obtenidas con el sensor realizando una prueba mediante punción dactilar usando un medidor de glucosa en sangre.**
- **Para confirmar hipoglucemia o hipoglucemia inminente informada por el sensor del Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre, realice una prueba mediante punción dactilar usando un medidor de glucosa en sangre.**
- **No pase por alto los síntomas que puedan ser consecuencia de hipoglucemia o hiperglucemia. Si tiene síntomas que no concuerdan con la lectura del Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre o sospecha que la lectura puede ser inexacta, verifique la lectura realizando una prueba mediante punción dactilar usando un medidor de glucosa en sangre. Si tiene síntomas que no concuerdan con sus lecturas de glucosa, consulte con su profesional de la salud.**

PRECAUCIÓN:

- **Es posible que, en ocasiones poco frecuentes, obtenga lecturas de glucosa con el sensor que no sean exactas. Si cree que sus lecturas no son correctas o no concuerdan con el modo en que se siente, realice una prueba de glucosa en sangre con sangre del dedo para confirmar su glucosa y verifique que el sensor no se haya aflojado. Si el problema continúa o el sensor se está aflojando, quite el sensor actual y aplique uno nuevo.**
- El ejercicio intenso puede causar que el sensor se afloje debido a la transpiración o al movimiento del sensor. Si el sensor se afloja, es posible que no obtenga lecturas o que obtenga lecturas que no sean confiables, que pueden no concordar con el modo en que se siente. Siga las instrucciones para elegir un lugar de aplicación adecuado.
- La deshidratación intensa y la pérdida excesiva de agua pueden dar lugar a resultados inexactos. Si cree que sufre de deshidratación, consulte con su profesional de la salud inmediatamente.
- No reutilice los sensores. El sensor ha sido diseñado de modo que no pueda ser usado nuevamente. No son aptos para reesterilizar.
- **El envase del sensor y el aplicador del sensor están empaquetados como un kit y tienen el mismo código del sensor. Verifique que los códigos del sensor sean los mismos antes de usar el envase del sensor y el aplicador del sensor. Los envases del sensor y los aplicadores del sensor que tengan el mismo código del sensor deben usarse juntos; de lo contrario, las lecturas de glucosa obtenidas con el sensor pueden ser incorrectas.**
- Algunas personas pueden ser sensibles al adhesivo que mantiene el sensor pegado a la piel. Si nota irritación significativa de la piel alrededor o debajo del sensor, quite el sensor y deje de usar el sistema FreeStyle Libre. Comuníquese con su profesional de la salud antes de continuar el uso del sistema FreeStyle Libre.

Descripción

Inicialmente, el sensor consta de dos piezas: una pieza se encuentra en el envase del sensor y la otra está en el aplicador del sensor. Siga las instrucciones para preparar y aplicar el sensor en la parte superior posterior del brazo. El sensor tiene una pequeña punta flexible que se introduce apenas por debajo de la piel. **El sensor se puede usar durante 14 días como máximo.**

Piezas del kit del sensor

Envase del sensor
Se utiliza con el aplicador del sensor para preparar el sensor para su uso.

Aplicador del sensor
Se utiliza para aplicar el sensor en el cuerpo.

Toallita humedecida con alcohol
Se utiliza para preparar la piel antes de la aplicación del sensor.

Seguridad para el usuario, conservación y manipulación

- El envase del sensor es estéril salvo que esté abierto o dañado.
- Conserve el kit del sensor entre 4 °C y 25 °C. Si bien no es necesario conservar el kit del sensor en el refrigerador, puede hacerlo siempre que el refrigerador se encuentre entre 4 °C y 25 °C.
- **El sensor ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que resiste la inmersión en un metro (3 pies) de agua durante 30 minutos como máximo.**
- No congelar. No usar si ha pasado la fecha de vencimiento.
- **Sustancias que causan interferencia: la ingestión de ácido ascórbico mientras se tiene puesto el sensor puede causar un aumento falso de sus lecturas de glucosa del sensor. La ingestión de ácido salicílico puede disminuir levemente sus lecturas de glucosa del sensor. El nivel de inexactitud depende de la cantidad activa de sustancia que causa interferencia en su cuerpo.**
- La toallita humedecida con alcohol tiene las siguientes indicaciones: torunda preinyección reliject | 1 torunda | Usar para limpiar la piel antes de una inyección | Saturada en alcohol isopropílico al 70 %. Instrucciones: rasgue la bolsita para abrirla y extraiga la torunda. Con un movimiento circular, frote la piel vigorosamente desde el lugar de la inyección hacia afuera. Para uso externo exclusivamente. Para un solo uso. Desechar después de usar. NUNCA usar para desinfectar un dispositivo médico invasivo. Precaución: mantener fuera del alcance de los niños. No poner en contacto con los ojos. En caso de que la torunda toque los ojos, enjuagar con agua. En el caso de irritación cutánea o exantema, suspender el uso. No usar después de la fecha de vencimiento. No reutilizar.

Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre

LEIA ESTE FOLHETO E O MANUAL DO USUÁRIO DO KIT DO LEITOR ANTES DE MANUSEAR AS PEÇAS DO KIT DO SENSOR.

Indicações de uso

O Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre é indicado para medir os níveis de glicose no líquido intersticial em pessoas (com 4 anos de idade ou mais) com diabetes mellitus. A indicação para crianças (de 4 a 17 anos) limita-se ao uso supervisionado por um cuidador com no mínimo 18 anos de idade. O cuidador é responsável por auxiliar a criança a lidar com o Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre e também por interpretar ou auxiliar a criança a interpretar as leituras do FreeStyle Libre. Ele é projetado para substituir os testes de glicose no sangue no autocontrole do diabetes, com as exceções listadas a seguir. **Sob as seguintes circunstâncias, utilize um medidor de glicose no sangue para conferir as leituras atuais de glicose do sensor do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre:**

- **Durante períodos de rápida alteração nos níveis de glicose, os níveis de glicose intersticial medidos pelo sensor e registrados como atuais podem não refletir com precisão os níveis de glicose no sangue.** Quando os níveis de glicose estão caindo rapidamente, as leituras de glicose do sensor podem estar mais altas do que os níveis de glicose no sangue. Por outro lado, quando os níveis de glicose estão subindo rapidamente, as leituras de glicose do sensor podem estar mais baixas do que os níveis de glicose no sangue.
- **A fim de confirmar uma hipoglicemia ou a iminência de uma hipoglicemia conforme registrada pelo sensor.**
- **Se os sintomas não corresponderem à leitura do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre. Os sintomas que possam ser decorrentes de níveis altos ou baixos da glicose no sangue não devem ser ignorados.**

CONTRAINDICAÇÃO:

O Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre deve ser removido antes da realização de um exame por ressonância magnética (RNM).

AVISO:

- O Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre contém pequenas peças que podem ser perigosas se engolidas.
- **Durante períodos de rápida alteração na glicose (mais de 2 mg/dL (0,1 mmol/L) por minuto), os níveis de glicose no líquido intersticial medidos pelo sensor do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre podem não refletir com exatidão os níveis de glicose sanguínea. Sob essas circunstâncias, confira as leituras de glicose do sensor conduzindo um teste por picada no dedo usando um medidor de glicose no sangue.**
- **A fim de confirmar uma hipoglicemia ou a iminência de hipoglicemia registrada pelo sensor do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre, faça um teste por picada no dedo usando um medidor de glicose no sangue.**
- **Não ignore sintomas que possam ser causados por níveis baixos ou altos de glicose no sangue. Se você tiver sintomas que não correspondam à leitura do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre ou suspeitar que a sua leitura possa estar incorreta, verifique a leitura realizando um teste por picada no dedo com o uso de um medidor de glicose no sangue. Se você estiver apresentando sintomas que não sejam compatíveis com as suas leituras de glicose, consulte um profissional de saúde.**

ATENÇÃO:

- **Em raras ocasiões, você pode obter leituras de glicose inexatas no sensor. Se você acredita que suas leituras não estão corretas ou são incompatíveis com o modo como você se sente, faça um teste de glicose no sangue em seu dedo para confirmar sua glicose e verifique se o sensor não se soltou. Se o problema continuar ou se o seu sensor estiver se soltando, remova o sensor atual e aplique um novo.**
- O exercício intenso pode fazer o sensor se soltar devido ao suor ou à movimentação do sensor. Se o sensor se soltar, você pode deixar de obter leituras ou obter leituras pouco confiáveis, que podem não corresponder com o modo como você se sente. Siga as instruções para selecionar um local de aplicação apropriado.
- A desidratação grave e a perda excessiva de água podem causar resultados inexatos. Se você acredita que está sofrendo uma desidratação, consulte imediatamente o seu profissional de saúde.
- Não reutilize os sensores. O sensor foi projetado de modo que não possa ser reutilizado. Não é adequado para reesterilização.
- **O recipiente do sensor e o aplicador do sensor são embalados como um conjunto e possuem o mesmo código. Verifique se os códigos do sensor correspondem entre si antes de usar o recipiente ou o aplicador do sensor. Os recipientes do sensor e os aplicadores do sensor com o mesmo código devem ser usados juntos; caso contrário as leituras de glicose do sensor podem ficar incorretas.**
- Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade ao adesivo que mantém o sensor aderido à pele. Se você notar uma irritação significativa na pele ou em volta do seu sensor, remova-o e pare de usar o sistema FreeStyle Libre. Entre em contato com seu profissional de saúde antes de continuar a utilizar o sistema FreeStyle Libre.

Descrição

O sensor vem inicialmente com duas peças: uma no recipiente do sensor, e a outra no aplicador do sensor. Siga as instruções para preparar e aplicar o sensor na parte de trás de seu braço. O sensor possui uma ponta pequena, flexível, que é inserida logo abaixo da pele. **O sensor pode ser usado por até 14 dias.**

Peças do Kit do sensor

Recipiente do sensor
Usado com o aplicador do sensor para preparar o sensor para o uso.

Aplicador do sensor
Aplica o sensor no corpo.

Lenço umedecido com álcool
Usado para preparar a pele antes da aplicação do sensor.

Segurança do usuário, armazenamento e manipulação

- O recipiente do sensor é estéril a menos que esteja aberto ou danificado.
- Armazene o Kit do sensor entre 4°C e 25°C. Apesar de você não precisar manter seu Kit do sensor em um refrgerador, você pode mantê-lo, desde que o refrigerador esteja entre 4°C e 25°C.
- **Seu sensor foi testado quanto à resistência em imersão em água de 1 m (3 pés) por até 30 minutos.**
- Não congele. Não utilize se a data de vencimento já passou.
- **Substâncias interferentes: Ingerir ácido ascórbico enquanto estiver utilizando o sensor pode aumentar de maneira falsa suas leituras de glicose do sensor. Ingerir ácido salicílico pode reduzir ligeiramente suas leituras de glicose do sensor. O nível de imprecisão depende da quantidade da substância interferente ativa no seu organismo.**
- O lenço umedecido com álcool está rotulado como mostra a seguir: lenço para pré-injeção reliject l 1 lenço l use para preparar a pele antes da aplicação da injeção l Saturado com álcool isopropílico a 70%. Instruções: Rasgue o saché e remova o lenço. A partir do local da injeção, esfregue a pele rapidamente em movimentos circulares, para fora. Apenas para uso externo. Apenas para uso único. Descarte após o uso. NUNCA utilize para desinfectar um dispositivo médico invasivo. Atenção: Mantenha longe de crianças. Mantenha longe dos olhos. Se houver contato com o lenço, lave com água. Caso ocorra irritação da pele ou erupção cutânea, interrompa o uso. Não use após a data de vencimento. Não reutilize.

FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System

READ THIS INSERT AND THE READER KIT USER'S MANUAL BEFORE HANDLING THE SENSOR KIT PARTS.

Indications for Use

The FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System is indicated for measuring interstitial fluid glucose levels in people (age 4 and older) with diabetes mellitus. The indication for children (age 4 - 17) is limited to those who are supervised by a caregiver who is at least 18 years of age. The caregiver is responsible for managing or assisting the child to manage the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System and also for interpreting or assisting the child to interpret FreeStyle Libre readings. It is designed to replace blood glucose testing in the self-management of diabetes with the exceptions listed below. **Under the following circumstances, use a blood glucose meter to check the current glucose readings from the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Sensor:**

- **During times of rapidly changing glucose levels, interstitial glucose levels as measured by the Sensor and reported as current may not accurately reflect blood glucose levels.** When glucose levels are falling rapidly, glucose readings from the Sensor may be higher than blood glucose levels. Conversely when glucose levels are rising rapidly, glucose readings from the Sensor may be lower than blood glucose levels.
- **In order to confirm hypoglycemia or impending hypoglycemia as reported by the Sensor.**
- **If symptoms do not match the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System reading. Symptoms that may be due to low blood glucose or high blood glucose are not to be ignored.**

CONTRAINDICATION:

The FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System must be removed prior to Magnetic Resonance Imaging (MRI).

WARNING:

- The FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System contains small parts that may be dangerous if swallowed.
- **During times of rapidly changing glucose (more than 2 mg/dL (0.1 mmol/L) per minute), interstitial fluid glucose levels as measured by the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Sensor may not accurately reflect blood glucose levels. Under these circumstances, check the Sensor glucose readings by conducting a fingerstick test using a blood glucose meter.**
- **In order to confirm hypoglycemia or impending hypoglycemia as reported by the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Sensor, conduct a fingerstick test using a blood glucose meter.**
- **Do not ignore symptoms that may be due to low or high blood glucose. If you have symptoms that do not match the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System reading or suspect that your reading may be inaccurate, check the reading by conducting a fingerstick test using a blood glucose meter. If you are experiencing symptoms that are not consistent with your glucose readings, consult your health care professional.**

CAUTION:

- **On rare occasions, you may get inaccurate Sensor glucose readings. If you believe your readings are not correct or are inconsistent with how you feel, perform a blood glucose test on your finger to confirm your glucose and check to make sure your Sensor has not come loose. If the problem continues or if your Sensor is coming loose, remove the current Sensor and apply a new one.**
- Intense exercise may cause your Sensor to loosen due to sweat or movement of the Sensor. If your Sensor comes loose, you may get no readings or unreliable readings, which may not match how you feel. Follow the instructions to select an appropriate application site.
- Severe dehydration and excessive water loss may cause inaccurate results. If you believe you are suffering from dehydration, consult your health care professional immediately.
- Do not reuse Sensors. The Sensor has been designed so that it cannot be reused. Not suitable for re-sterilization.
- **The Sensor Pack and Sensor Applicator are packaged as a set and have the same Sensor code. Check that the Sensor codes match before using your Sensor Pack and Sensor Applicator. Sensor Packs and Sensor Applicators with the same Sensor code should be used together or your Sensor glucose readings may be incorrect.**
- Some individuals may be sensitive to the adhesive that keeps the Sensor attached to the skin. If you notice significant skin irritation around or under your Sensor, remove the Sensor and stop using the FreeStyle Libre system. Contact your health care professional before continuing to use the FreeStyle Libre system.

Description

The Sensor initially comes in two parts: one part is in the Sensor Pack and the other part is in the Sensor Applicator. Follow the instructions to prepare and apply the Sensor on the back of your upper arm. The Sensor has a small, flexible tip that is inserted just under the skin. **The Sensor can be worn for up to 14 days.**

Sensor Kit Parts

Sensor Pack
Used with Sensor Applicator to prepare Sensor for use.

Sensor Applicator
Applies Sensor to body.

Alcohol Wipe
Used to prepare skin before Sensor application.

User Safety, Storage, and Handling

- The Sensor Pack is sterile unless opened or damaged.
- Store the Sensor Kit between 4 °C–25 °C. While you don't need to keep your Sensor Kit in a refrigerator, you can as long as the refrigerator is between 4 °C–25 °C.
- **Your Sensor has been tested to withstand immersion into one meter (3 ft) of water for up to 30 minutes.**
- Do not freeze. Do not use if expiration date has passed.
- **Interfering Substances: Taking ascorbic acid while wearing the Sensor may falsely raise your Sensor glucose readings. Taking salicylic acid may slightly lower your Sensor glucose readings. The level of inaccuracy depends on the amount of the interfering substance active in your body.**
- The alcohol wipe is labeled as follows: reliject pre-injection swab | 1 swab | Use for skin cleansing prior to injection | Saturated with Isopropyl Alcohol 70%. Directions: Tear the sachet open and remove the swab. From the site of injection, briskly rub the skin in a circular motion, moving outward. External use only. Single use only. Discard after use. NEVER use to disinfect an invasive medical device. Caution: Keep away from children. Keep away from eyes. If a swab makes contact, rinse with water. In the event of skin irritation or rash, discontinue use. Do not use after expiration date. Do not reuse.

©2016 Abbott ART29597-105 Rev. B 11/16

Símbolos de las etiquetas | Símbolos de rotulagem | Labeling Symbols

CODE	Código del sensor | Código do sensor | Sensor code
	No reutilizar | Não reutilizar | Do not re-use
STERILE R	Esterilización mediante radiación | Esterilizado por irradiação | Sterilized using irradiation
	Fecha de vencimiento | Data de validade | Use-by date
SN	Número de serie | Número de série | Serial number
	Precaución | Atenção | Caution
	Límite de temperatura | Limite de temperatura | Temperature limit
	No utilizar si el embalaje está dañado | Não utilize se a embalagem estiver danificada | Do not use if package is damaged
	Pieza aplicada tipo BF | Peça aplicada tipo BF | Type BF applied part
	Fabricante | Fabricante | Manufacturer
	Consulte las instrucciones de uso | Consultar instruções de uso | Consult instructions for use
LOT	Código de lote | Código do lote | Batch code
REF	Número de catálogo | Número de catálogo | Catalog number
	Límites de humedad | Limites de umidade | Humidity limitation
	Este producto no debe desecharse mediante la recolección municipal de residuos. Comuníquese con el fabricante para obtener detalles. Este produto não deve ser descartado através da coleta de lixo comum. Entre em contato com o fabricante para maiores detalhes. This product must not be disposed of via municipal waste collection. Contact the manufacturer for details.

Distribuido por | Distribuído por | Distributed by:

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Abbott Diabetes Care
Rua Michigan, 735
Cidade Monções
04566-905 São Paulo, SP
Brasil
CNPJ: 56.998.701-0001-16
Responsável Técnico:
Danielle Parizi Angelino
CRF-SP 31.754
RMS: 80146501903
0800-703 0128

Abbott Laboratories Argentina SA
Abbott Diabetes Care
Ing. Butty 240 - Piso 12
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARGENTINA
C1001 AFB
0-800-800-6334

Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Abbott Diabetes Care
Av. El Salto nº 5380 -Huechuraba
Santiago, Chile
800 802 226

FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. Other trademarks are the property of their respective owners.

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

Abbott